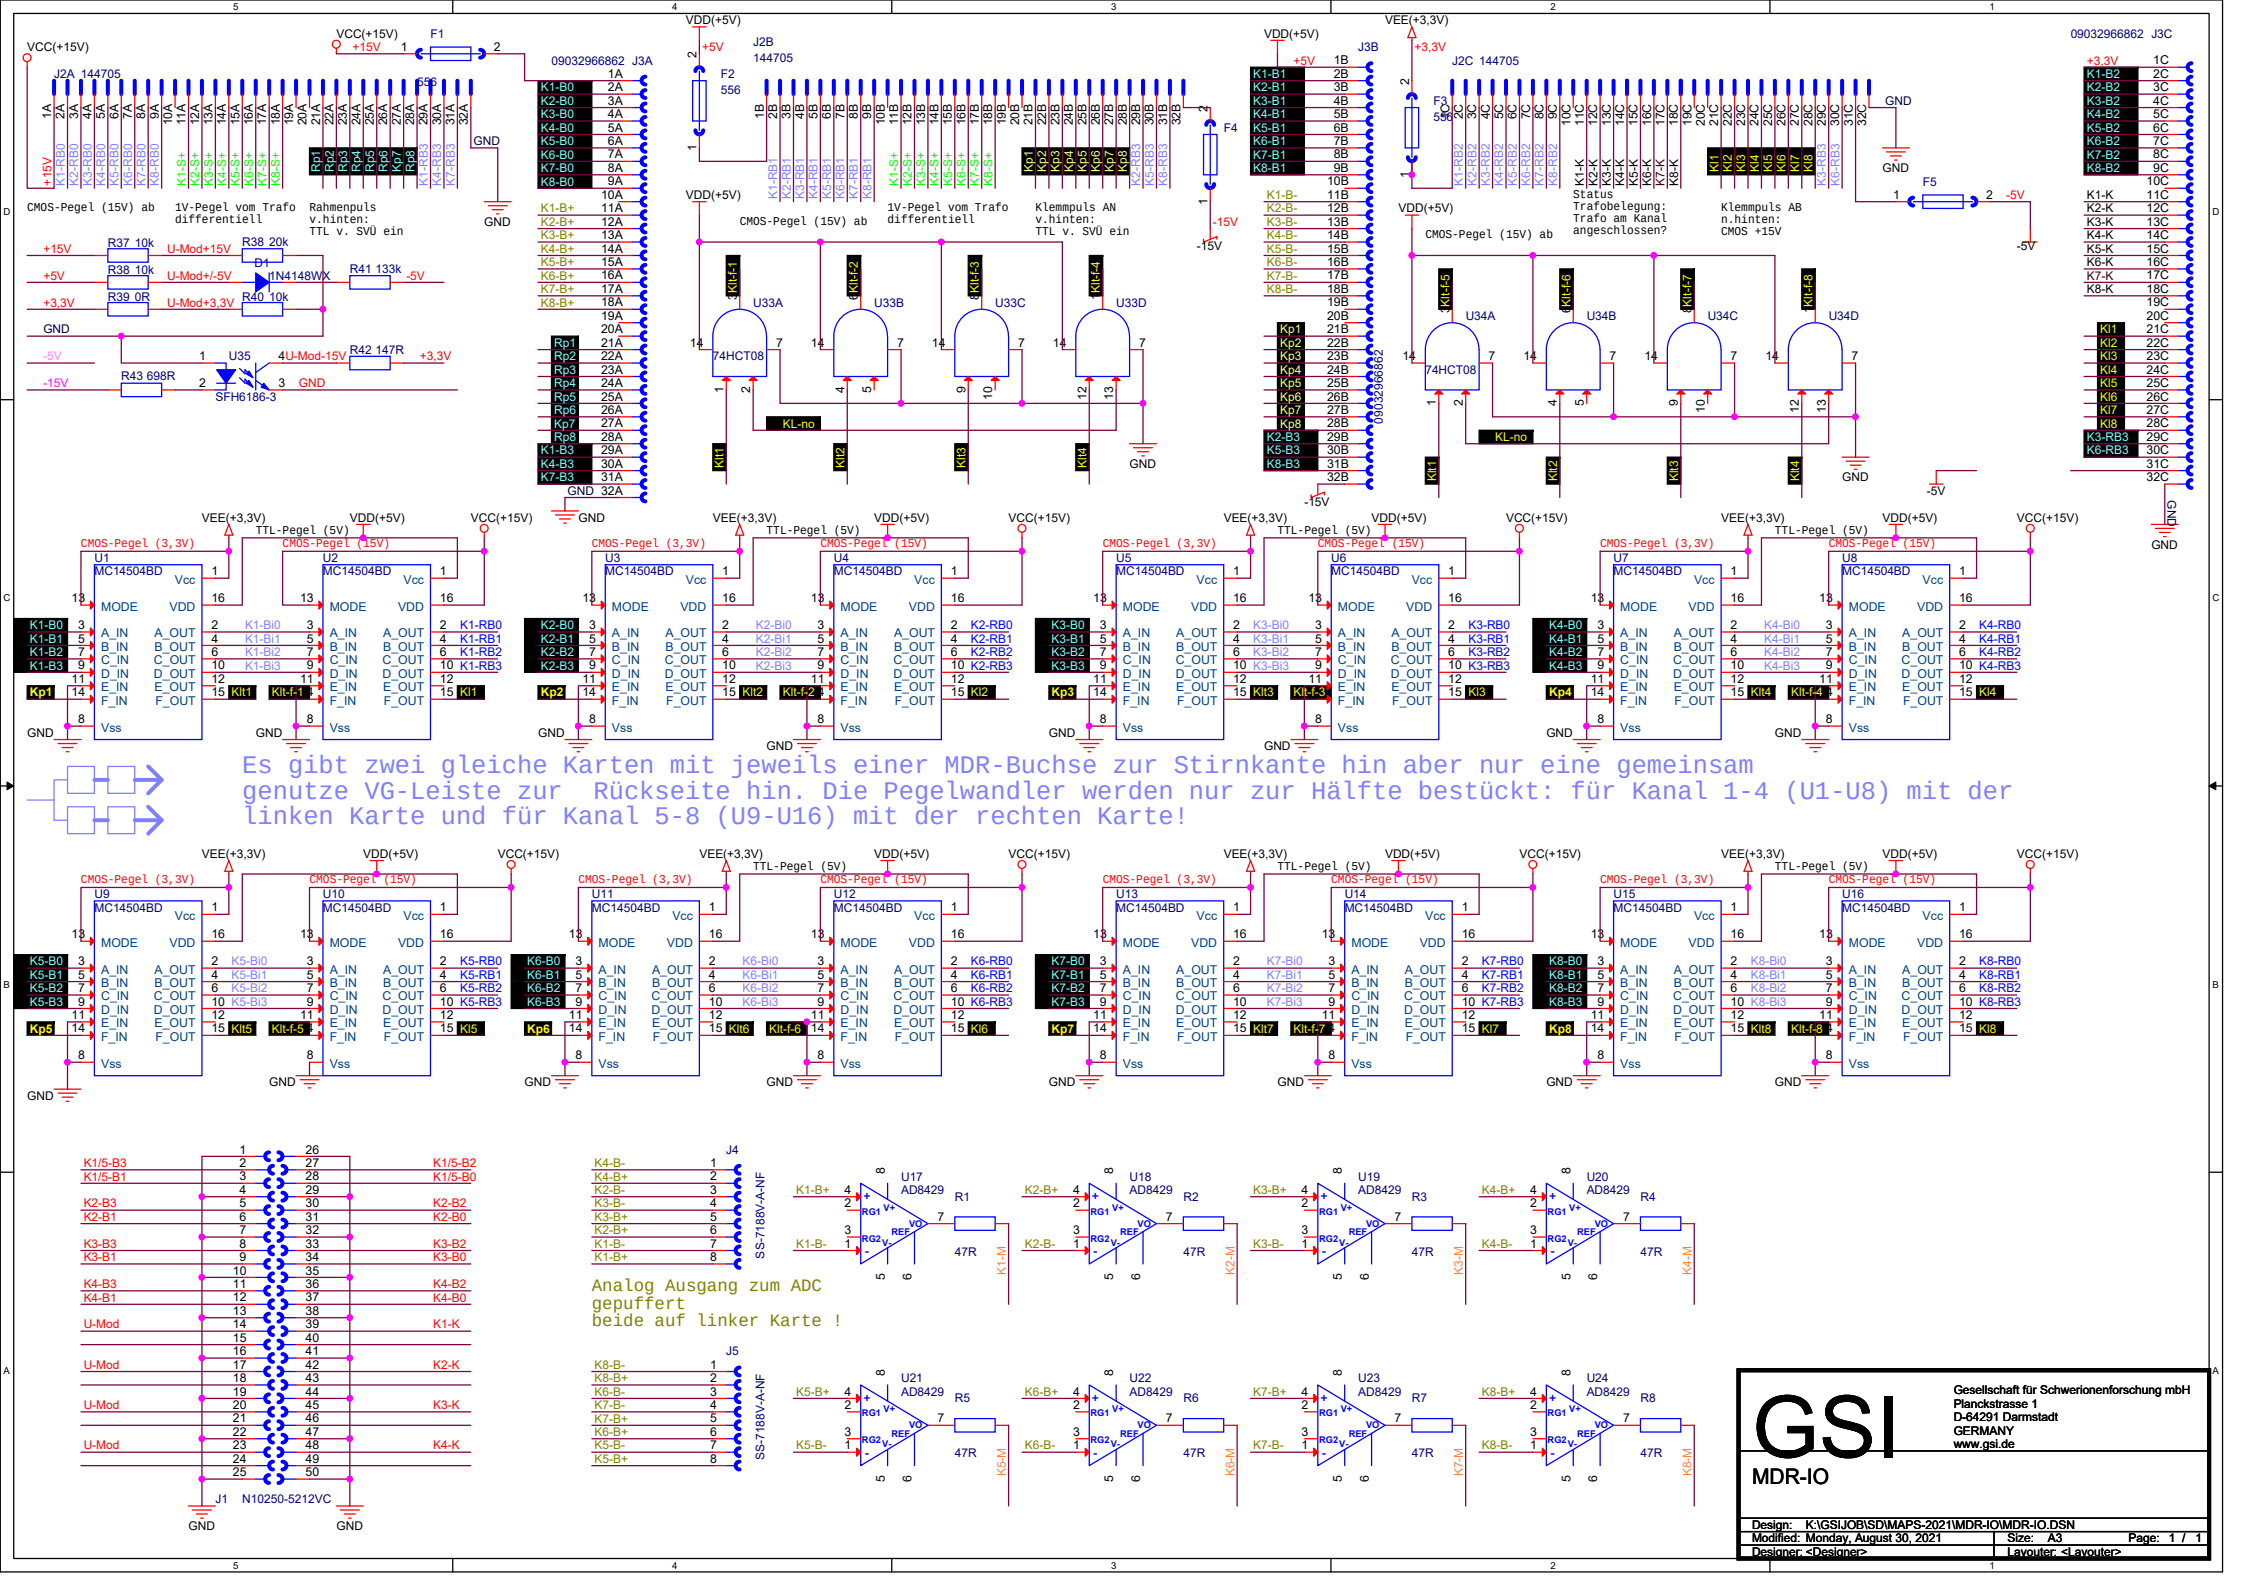
Es gibt zwei gleiche Karten mit jeweils einer MDR-Buchse zur Stirnkante hin aber nur eine gemeinsam genutze VG-Leiste zur Rückseite hin. Die Pegelwandler werden nur zur Hälfte bestückt: für Kanal 1-4 (U1-U8) mit der linken Karte und für Kanal 5-8 (U9-U16) mit der rechten Karte!
Analog Ausgang zum ADC gepuffert beide auf linker Karte !
GSI
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH
Planckstrasse 1
D-64291 Darmstadt
GERMANY
www.gsi.de
MDR-IO
Design: K:\GSI\JOB\SD\MAPS-2021\MDR-IO\MDR-IO.DSN
Modified: Monday, August 30, 2021
Size: A3
Page: 1 / 1
Designer: <Designer>
Layouter: <Layouter>