Detail X
M 1:1



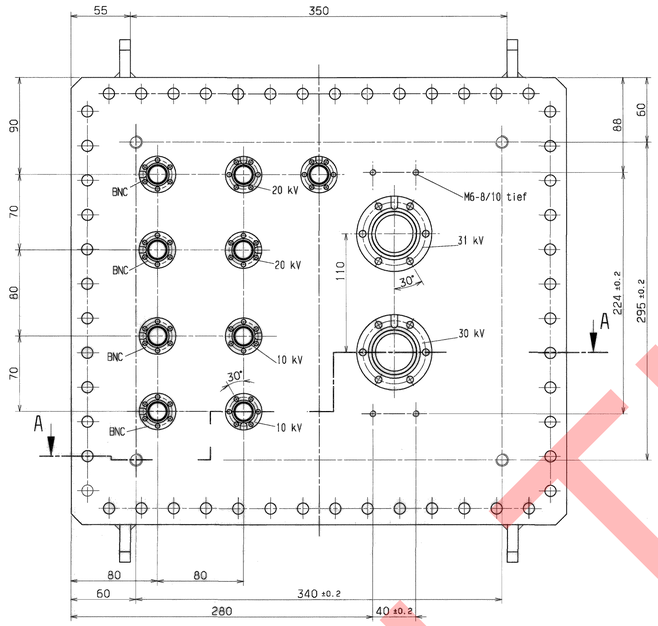

Schnitt A-A

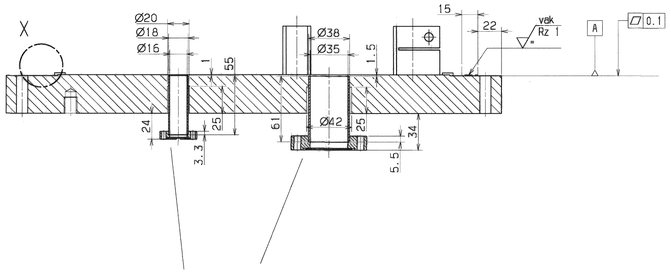

UHV-vakuumdicht geschweisst
Integral-Leckrate: kleiner $1*10^{-9}$ mbar*l/s
heliumdicht bei 10^{-9} mbar

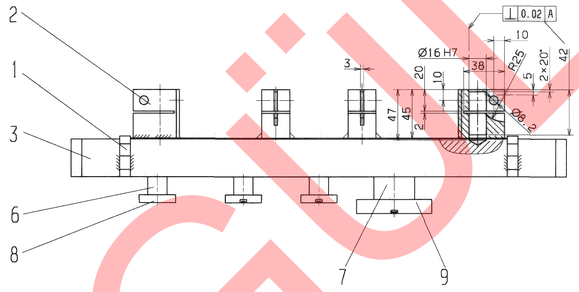

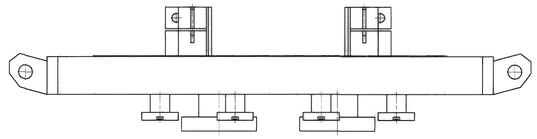

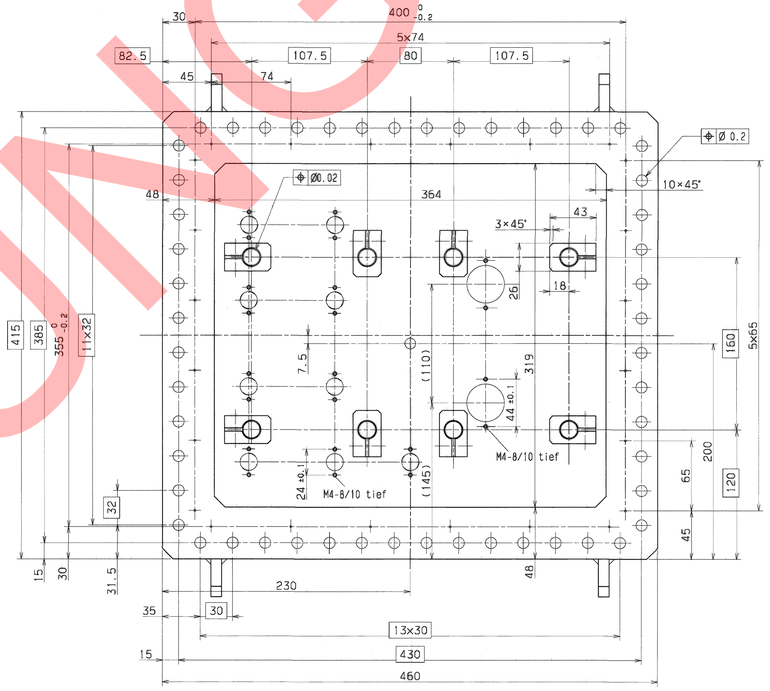

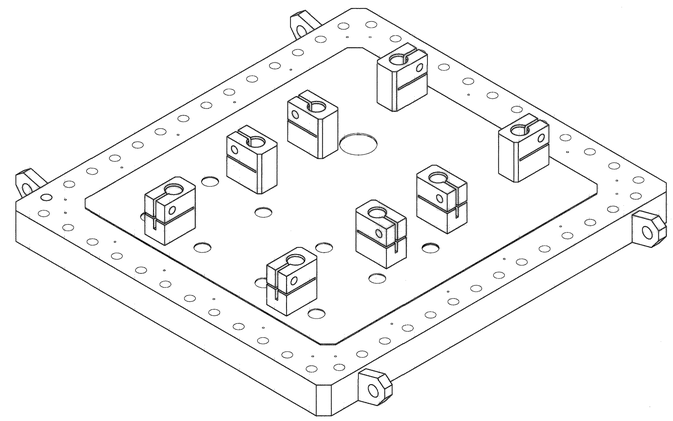

ultraschallgereinigt

entgratet

$\sqrt{Rz\ 25}$ ($\sqrt{\text{vdK Rz 1}}$)

Fertigung entsprechend
beiliegender Spezifikation:

Datum:	Ausgabe:	Datum:
~~07/1~~	~~1~~	~~vom 14.12.92~~
~~02/1~~	~~1~~	~~vom 14.12.92~~
~~03/1~~	~~1~~	~~vom 14.12.92~~
04/1	1	vom 14.12.92
05/1	1	vom 14.12.92
07/1	1	vom 16.12.92

UNGÜLTIG

Copyright GSI Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH, Planckstr. 1, D-64291 Darmstadt, Germany. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

VERGLEICH DER OBERFLÄCHENGÜTEN				FREIHEITS-TOLERANZEN	GEWICHT KG / STCK	WERKSTOFF	MASSSTAB
	DIN ISO	ENG		ISO 2768-m			1:2 (1:1)
BEARB.	12.5	3.2	0.8	0.2			
	N10	125	N6	N5			BLATT-NR
RZ	0.4	16	0.025	0.012			
DIN 3141 REIHE 2				1998 TAG MONAT			
				BEARB. 5.11.			BLATTANZAHL
				GEPR.		Grundplatte	
				NORM			
a	zus. TABES >DRAHT 12.98 Stb			GSI DARMSTADT		DA 020.120 a	
AUS-GABE	RENDERUNG	TAG	NAME	ERSATZ FÜR:	ERSETZT DURCH:		
Gloecner				DECEMBER 1, 1998			